

# CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 004937

Página 1 de 5

**LABORATORIO:**

DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

*Laboratory*

**INSTRUMENTO:**

PLANCHA DE TERMOFUSIÓN

*Instrument*

**FABRICANTE:**

CENTRAL

*Manufacturer*

**MODELO:**

2 SW

*Model*

**NUMERO DE SERIE:**

TP-9

*Serial Number*

**UBICACIÓN**

LABORATORIO DE METROLOGIA

*Location*

**RANGO DE MEDICION:**

0 - 480 °F

*Measurement Range*

**RESOLUCIÓN:**

10

*Resolution*

**SOLICITANTE:**

LIDER DE METROLOGIA

*Customer*

**DIRECCIÓN:**

CALLE 39 D N° 28-52 EMPORIO

*Address*

**FECHA DE RECEPCIÓN:**

2021-10-14

*Date of Reception*

**FECHA DE CALIBRACIÓN:**

2021-10-19

*Date of Calibration*

**NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:**

5

*Number of Pages and Document Attached*

**Calibrado Por:**

*Calibrate by:*



YEISON QUINCHUCUA

*Técnico en Metrología*

**Aprobado Por:**

*Checked by:*



Ing. Fabian Contreras

*Jefe Laboratorio de Metrología*

*Fecha De Emision null*

*Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.*

*This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.*

**1. No de Informe 4937***Internal Code***2. Trazabilidad de la Medición***Traceability*

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

<b>Descripción (Description)</b>	<b>TERMOCUPLA PATRON/FLUKE(SN TC5618109)</b>
<b>Tipo (Type)</b>	TEMPERATURA
<b>Fabricante (Manufacturer)</b>	FLUKE
<b>Serie</b>	TC5618109
<b>Rango de Medición</b>	-32 - 500 °F
<b>Resolución</b>	1 °F
<b>Certificado de Calibración</b>	CLT 165921

**3. Metodo de Calibración.***Calibration Method*

*Comparación directa con termopar patrón Tipo K de superficie TESTO 925.*

*Se efectuan 5 mediciones en cada superficie del equipo, en cada esquina y en el centro; durante un periodo de estabilización.*

**4. Incertidumbre Estimada de la Medición.***Measurement uncertainty*



*La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura  $k = 2,00$ , con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.*

**5. Condiciones Ambientales***Environmental Conditions*

Temperatura Ambiente <i>Room Temperature</i>	24.3 +/- 0.6 °C
Humedad Relativa <i>Relative Humidity</i>	47.0 +/- 3 HR
Voltaje en la Fuente	110.0 Vac



6. Resultados de la Calibración

CARA	Indicación Instrumento °F	Indicación Patrón °F	Error Max. Relativo °F	RESULTADO
<b>Superior</b>	520.0	518.0	-38,000	Error
	520.0	520.0	-40,000	43.000
	520.0	523.0	-43,000	U
	520.0	518.0	-38,000	0.982
	520.0	520.0	-40,000	
<b>Inferior</b>	528.0	522.0	-42,000	Error
	520.0	518.0	-38,000	-42.000
	520.0	520.0	-40,000	U
	520.0	515.0	-35,000	-0.962
	520.0	518.0	-38,000	

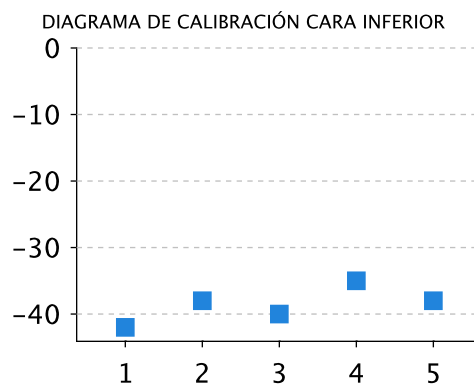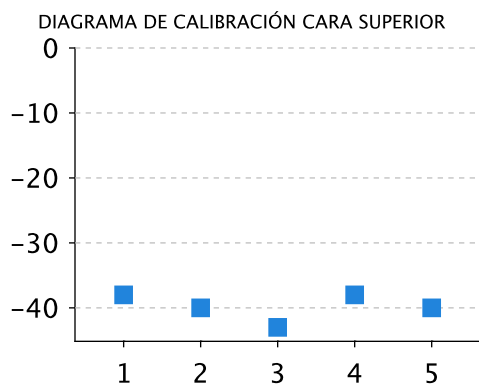

<b>Error Cara Superior (°F) =</b>	<b>43,000 ± 0,982</b>
<b>Error Cara Inferior (°F) =</b>	<b>-42,000 ± -0,962</b>

CARA	Indicación Instrumento °F	Indicación Patrón °F	Error Max. Relativo °F	RESULTADO
Superior	520.0	528.0	-48,000	Error
	520.0	520.0	-40,000	48.000
	520.0	518.0	-38,000	U
	520.0	518.0	-38,000	2.539
	520.0	518.0	-38,000	
Inferior	520.0	518.0	-38,000	Error
	520.0	420.0	60,000	60.000
	520.0	520.0	-40,000	U
	520.0	521.0	-41,000	33.047
	520.0	518.0	-38,000	

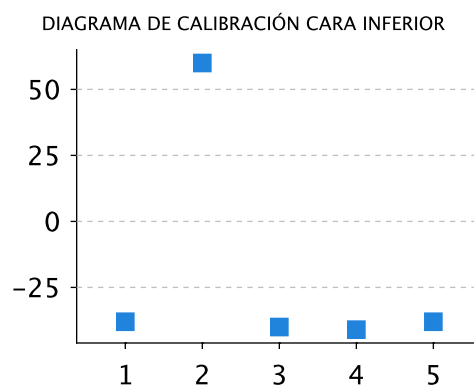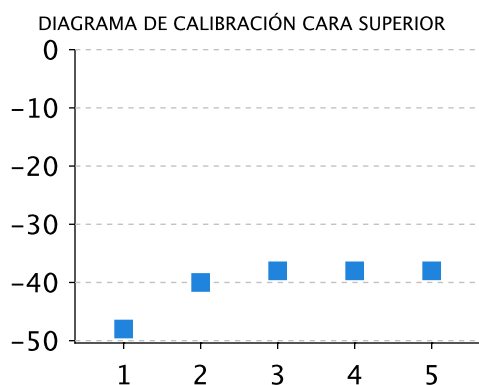

<b>Error Cara Superior (°F) =</b>	<b>48,000</b>	<b>±</b>	<b>2,539</b>
<b>Error Cara Inferior (°F) =</b>	<b>60,000</b>	<b>±</b>	<b>33,047</b>

## 7. Observaciones

*Remarks*

*\* Con el certificado de calibración se entrega una estampilla del Departamento de Metrología de Llanogás SA ESP, que contiene fecha y número del certificado de calibración, la cual va adherida al equipo.*

*\* A la temperatura indicada por el termómetro bimetalico es necesario realizarle un ajuste igual a la lectura registrada por el indicador bimetalico menos el promedio de operación del equipo, registrado en el presente informe.*

*\* equipo se pone fuera de servicio con informe de Ingeniería 455*